



ASPEN® LSO

LUMBAR SACRAL ORTHOSIS
LUMBAL-SAKRALE ORTHESE

ORTÉSIS LUMBOSACRA

ORTESI SACRO-LOMBARE

ORTHÈSE LOMBO-SACRÉE

LUMBAL SCRALE ORTHESE

BEDERNÍ KŘÍZOVÁ ORTÉZA

LUMBAL SAKRAL ORTOZE

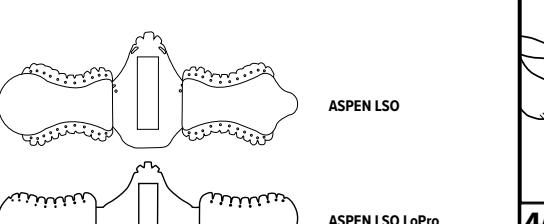
ΟΣΦΥΓΙΚΗ ΟΡΘΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ

LUMBAL KORSRYGGORTROE

ORTEZA LEDŽWIOWO-KRZYŻOWA

LANNERANGAN SAKRAALINEN ORTOOSI
LUMBAL SAKRAL ORTOZOPTEZ DLA ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
ОРТЕЗЕС САРО САЛМАР

腰骶矫形器



ASPIEN LSO

ASPIEN LSO LoPro



















MD MEDICAL DEVICE

SINGLE PATIENT-MULTIPLE USE

CAUTION



Pat. aspenmp.com/patents

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200
©2023 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.
LS0014M revised 03/2023

ENGLISH

DEUTSCH ASPEN MEDICAL PRODUCTS GmbH Im Leuschenpark 4, 64347 Griesheim aspenmp.de • +49 (0) 6155 89791-0 · Pat. aspenmp.de/patents

1. SIZE SELECTION

A. Match the patient's height and girth to the correct size LSO. Hold the back panel up to the patient and note the location and amount of lordotic curve.
B. Use the edge of a table to bend the aluminum rods in the back panel as needed. Test and adjust as needed.

2. ASSEMBLY

A. Average the patient's waist and lower rib circumference. Slide the ends of the back panel into the curved slots so the end is "hidden" under the side panels.
B. Using the average circumference, seat the rivets in the appropriate SureSlot™ openings and pull firmly to snap in place.

3. POSITIONING

A. Position the patient so the back panel is centered and properly located on the back. Ambulatory patients may hold their brace while it is being tightened.
B. Attach the black hook start tab to the loop slot on the opposite side panel. If the hook start tab is too long or too short, the brace should be re-adjusted.

4. TIGHTENING

A. Loop the 1.5" wide center strap through the LeverLatch™. Securely attach the loop and push down as you move the LeverLatch to the patient's right side to tighten the brace.
B. Attach and tighten the upper and lower straps to wrap up the slack. Repeat LeverLatch tightening and upper / lower strap tightening as needed.

5. COLD THERAPY

A. Drill holes in the 2.0 cm (1.5" Zell) broden mittleren Gurt durch den LeverLatch™.
B. Befestigen Sie die Schlaufe fest und drücken Sie nach unten, während Sie den LeverLatch zur rechten Seite des Patienten bewegen, um die Stütze anzupassen.
C. Befestigen Sie die oberen und unteren Streifen und ziehen Sie sie fest, um den Schnupf aufzunehmen. Wiederholen Sie das Festziehen des LeverLatch und das Festziehen des oberen/unteren Streifens nach Bedarf.

6. FESTZIEHEN

A. Füllen Sie die 2.0 cm (1.5" Zell) breiten mittleren Gurt durch den LeverLatch™.

B. Befestigen Sie die Schlaufe fest und drücken Sie nach unten, während Sie den LeverLatch zur rechten Seite des Patienten bewegen, um die Stütze anzupassen.

C. Befestigen Sie die oberen und unteren Streifen und ziehen Sie sie fest, um den Schnupf aufzunehmen. Wiederholen Sie das Festziehen des LeverLatch und das Festziehen des oberen/unteren Streifens nach Bedarf.

7. MODIFICATION OPTIONS

This product may be substantially modified by an individual with expertise. For more information, please visit www.aspenmp.com/education/product-modifications.

INTENDED USE

To provide motion restriction of the lumbar-sacral spine.

INDICATIONS

Postoperative support, Deconditioned trunk musculature, Post laminectomy syndrome, Surgical Decompression procedures, Non-surgical Decompression procedures, Degenerative disc disease, Bulging or herniated disc, Non-specific low back pain, Chronic low back pain, Fracture management, Spondylosis, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligament sprains / Muscle strains, Spondylolisthesis / Degenerative Joint Disease, Facet syndrome, SI dysfunction, Sacroiliitis, Radiculopathy, Injections, Radiofrequency ablation, Lumbar Multifidus Muscle Atrophy.

CONTRAINDICATIONS

Postoperative Unstability, untrained Bumpmuskulatur, Post laminectomy-Syndrom, chronische Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule, degenerative Bandscheibenveränderungen.

PRECAUTIONS

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered as medical recommendations. If you suffer from a serious medical condition, we strongly suggest that you consult with a licensed health care professional before using this product. Proper fitting is required for this product to be effective. Under some circumstances, this product may be prescribed by a physician. Please see the limited warranty for further information.

CARE INSTRUCTIONS

Rinse with warm water at 30°C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other chemicals.

MATERIALS

HDPE, LDPE, Nylon, Polyurethane, Cotton, Aluminum.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

DISPOSAL

Product may be safely disposed in accordance with local laws.

REPORTING

Please report any serious incident involving the use of this device to both the Competent Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).

LIMITED WARRANTY

LESEN SIE VOR DEM GEBAEHN DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Geräts sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen eignen sich nicht für medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn Sie unter einer ernsten Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

READING INSTRUCTIONS BEFORE USE

LESEN SIE VOR DEM GEBAEHN DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Geräts sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen eignen sich nicht für medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn Sie unter einer ernsten Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

CARE INSTRUCTIONS

Hand wash only at 30°C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other chemicals.

MATERIALS

HDPE, LDPE, nylon, poliuretano, cotone, alluminio.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

DISPOSAL

Product may be safely disposed in accordance with local laws.

REPORTING

Please report any serious incident involving the use of this device to both the Competent Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).

LIMITED WARRANTY

LESEN SIE VOR DEM GEBAEHN DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Geräts sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen eignen sich nicht für medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn Sie unter einer ernsten Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

READING INSTRUCTIONS BEFORE USE

LESEN SIE VOR DEM GEBAEHN DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Geräts sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen eignen sich nicht für medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn Sie unter einer ernsten Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

CARE INSTRUCTIONS

Hand wash only at 30°C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other chemicals.

MATERIALS

HDPE, LDPE, nylon, poliuretano, Baumwolle, Aluminium.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

ENTSORGUNG

Das Produkt kann sicher entsprechen den örtlichen Gesetzgebungen entsorgt werden.

MEIDUNG

Bei jedem anderen Incidente gravierend als der Verlust des Produktes.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantiert dem Benutzer, dass dieses Produkt ursprünglich gekauft hat, dass es frei von Defekten oder Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Die Garantie ist auf die ersten 12 Monate ab dem Kaufdatum beschränkt.

GARANTIE

Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte und Sie haben weitere Rechte, die von Landesgesetz bestimmt werden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nur für Produkte, die von einem autorisierten Händler gekauft wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die von einem unbefugten Händler gekauft wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aus Mangel an Pflege oder Wartung entstanden sind.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Unfalls beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Wasserschadens beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

GARANTIE

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die aufgrund eines Brandes beschädigt wurden.

DANSK	ELLIINKA	NORSK	POLSKI	SUOMI	SVENSKA	РУССКИЙ	PORTUGUÉS	中文
<p>1. VALG AF STORRELSE</p> <p>A. Find patientsens højde og omkreds til den rigtige storrelse LSO. Hold bagpanelet op til patienten og noter placeringen og mångden af lordotisk kurve.</p> <p>B. Brug kanten af et bord til at bøje aluminiumsstængerne i bagpanelet efter behov. Lav en test og juster om nødvendigt.</p> <p>2. MONTERING</p> <p>A. Monter patienten på patienten på den nede ribben. Skub underne af bagpanelet ind i den buede riller, så enden er "skjult" under sidopanelelet.</p> <p>B. Brug den gennemsnitlige omkreds til at placere nitteme i den relevante SureSlot®-åbning og træk for at klippe på plads.</p> <p>3. PLACERING & LUKNING</p> <p>A. Placer patienten, så bagpanelet er centreret og korrekt placeret på bagsiden.</p> <p>B. Monterende patient kan eventuelt have bøjlen, mens den strammes.</p> <p>C. Fastgør den sorte storklapp til krog til høj/prikken på det modstødte sidopanel. Hvis storklappen til krog er for lang eller for kort, skal bøjlen justeres igen.</p> <p>4. STRAMMING</p> <p>A. Snor den 1,5" brede midtstrøppen genlem LeverLatch™. Fastgør strøppen til den nederste del af bagsiden.</p> <p>B. Fastgør og stram de øverste og nederste stopper for at fjerne det løse. Gentag nu stramming med LeverLatch og vrede / øvre strøpp stramning efter behov.</p> <p>5. TILPÅSLÆNG</p> <p>A. Hvis plastankanter ikke er behagelige, skal du skære fra bunden af flexspalten til det tilstøttende hul for at reducere trykket.</p> <p>B. Det/drej støttelag kan også trimmes for at rumme anatomier. Tag aluminiumsnittene væk, der holder stroppen og tappinen, og nit dem igen i de forbordede huller. Trin deraf efter.</p> <p>6. KOLD TERAPI</p> <p>VALGRIFT: Ekstra omkostningspost.</p> <p>A. Fjern skummet i bagpanelet.</p> <p>B. Fastgør den nye skumpute på bagpanelet.</p> <p>C. Sæt den froste koldestarterpakk i posen på den nye skumpute.</p> <p>7. ANDRINGSMULIGHEDER</p> <p>Dette produkt kan ændres af en person med ekspertise. Du kan finde flere oplysninger på www.aspennmp.com/education/product-modifications.</p> <p>ANVENDELSESFORMÅL</p> <p>Før at give bevegelsesbegrenсsning af lænde/hvirvelsøjlen.</p> <p>INDIKATIONER</p> <p>Postoperativ støtte, Dekonditioneret trunk muskulatur, Post laminektomi syndrom, Kirurgisk dekompressionsprocedurer, ikke-kirurgisk dekompressionsprocedurer, støttesystemer/strekstumper, spondylos (slidig/til/degenerativ ledsgydom), facetsyndrom, SI-syndrom, sacroiliitis, radikulopati, injektorioner, radiofrekvensablation, lumbar multifidus muskelerat.</p> <p>KONTRAINDIKATIONER</p> <p>Oversædmedler eller allergi over for de materialer, bøjlen er fremstillet af. Hvisvelse i lymfevarvet forårsaget af kredsløbsygdomme. Patienter, der ikke har tilladelse til at bære en bøjle i hænden til medicinske instruktøren.</p> <p>FORHOLDSREGLER</p> <p>DISSENT INSTRUKTIONER SKAL LAEVES FOR BRUG. Korrekt træning i bruk af denne enhed skal finde sted,inden den anvendes. Disse anvisninger er kun retningssignaler og skal ikke bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand, er det kraftigt anbefalet at du konsulterer en autoriseret sundhedsperson, inden du bruger dette produkt. En korrekt monitoring er kravet for at dette produkt skal være effektivt. Under nogle omstændigheder kan dette produkt ordineres af en lege. Se den begrænsede garanti for yderligere information.</p> <p>PLEJEINSTRUKTIONER</p> <p>Håndvask kun ved 30 °C. Vask med en mild rengøringsmiddel; Lufttørring; Brug ikke blejemiddel eller andre kemikalier.</p> <p>MATERIALE</p> <p>HDPE, LDPE, Nylon, Polyurethan, Bomuld, Aluminium.</p> <p>DER ER INTET NATURGUMMIMATTE I ENHEDEN.</p> <p>MED HENSYN TIL TØRTSKAFFELSE</p> <p>Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.</p> <p>RAPPORTERING</p> <p>Venligst rapportér enhver alvorlig hændelse, der involverer brugen af denne enhed til både den kompetente myndighed i din stat og til producenten (angivet i dette dokument).</p> <p>DEGR-ENSET GARANTI</p> <p>Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der opnederlande keber dette produkt, at det er fri for mangler i materiale og udførelse. Den eneste forpligtelse Aspen Medical Products, LLC har i tilfælde af misslydekning af garantien er reparasjon af udførelsen af det tekniske eller defekte produktet eller deler.</p> <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet er ikke leveret af Aspen Medical Products, LLC og er uafhængig af den tekniske produktet eller deler. <p>Aspen Medical firmær, LLC er ikke forpligtet til at hænde til denne begrensede garanti i tilfælde af:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af autoriserede distributionskanaler; (b) Det er blev								